


GL10-TKで 冷蔵庫（冷凍庫）の温度監視

【業種】
サービス
修理

業務用冷蔵庫（冷凍庫）の温度データを測定。修理等のご提案に！
..... データロガー本体は冷蔵庫の外に設置、熱電対は冷蔵庫内に配線し、
温度変化を測定します。

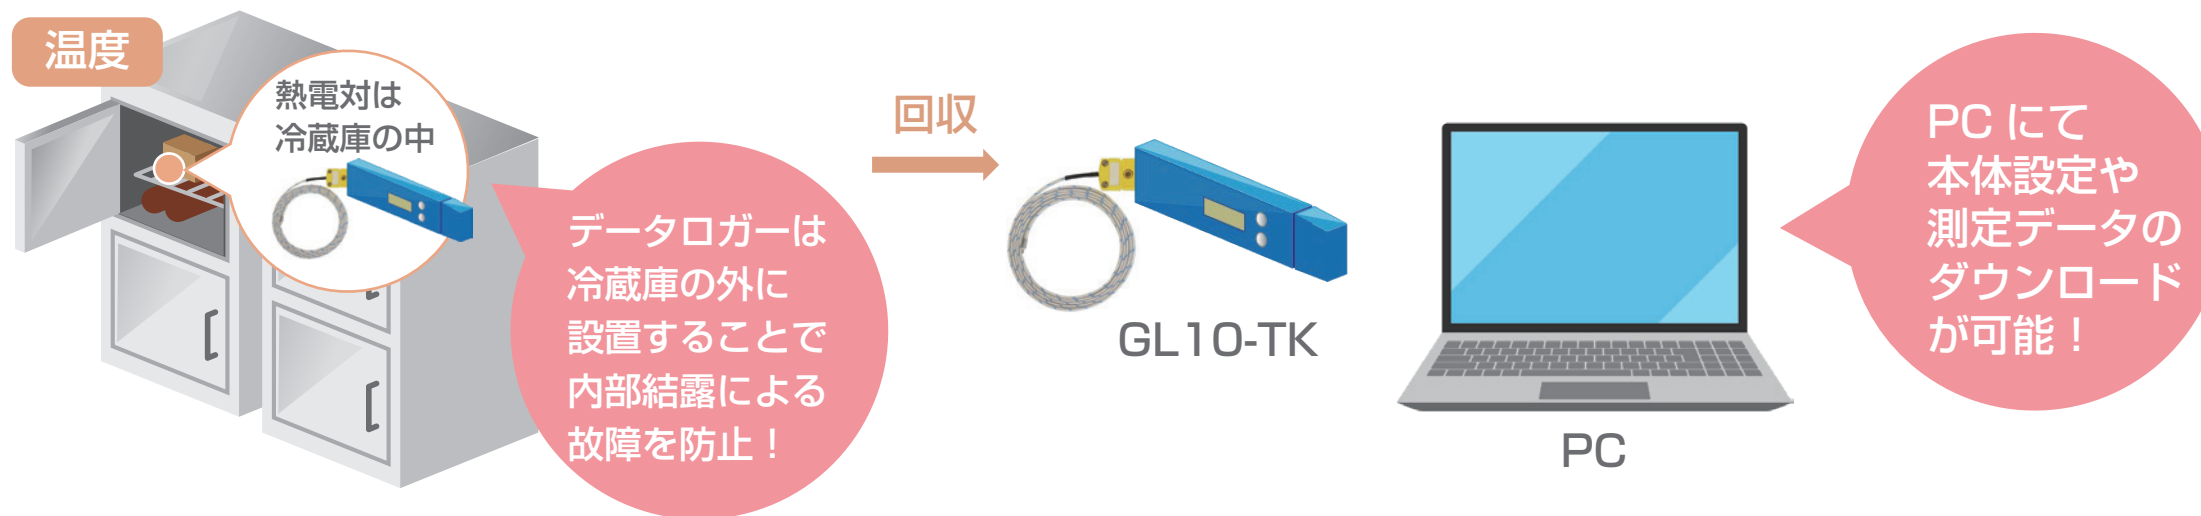

冷凍庫の場合はオプションの
フッ素樹脂被覆 K 型熱電対「JBS-7115-5M-K」
をご使用ください



midi LOGGER GL10-TK（熱電対タイプ）

GL10 用 K 型熱電対（付属熱電対）

長さ：1m / ガラス被覆 / 測定温度範囲：0℃～250℃

オプション



JBS-7115-5M-K（K 型熱電対：5 本入り）

長さ：5m / フッ素樹脂被覆

/ 測定温度範囲：-40℃～200℃